




		Подъёмник Y401/1 Y401/2 Y401/3	Подъёмник Y402/1 Y402/2 Y402/3	Подъёмник Y403/1 Y403/2 Y403/3	Подъёмник Y404/1 Y404/2 Y404/3
Характеристика	Маркер	в мм	в мм	в мм	в мм
Высота под подвесом	h	95	95	95	90
Длина в сложенном положении	l	-	-	1220	-
Высота в сложенном положении	j	-	-	310	-
Самое высокое положение	k	1845	1917	1786	1845
Самое низкое положение	l	695	1284	695	695
Область подъёма	m	1150	633	1090	1150
Макс внутренняя ширина (ножки раздвижнуты)	p	960	960	790	960
Внутренняя ширина при макс. досягаемости	q	476-960	476-960	420-790	476-960
Мин. внутренняя ширина (ножки сдвинуты)	r	476	476	420	476
Макс. внутренняя ширина (ножки сдвинуты)	s	476	476	420	476
Внешняя ширина (ножки сдвинуты)	u	595	595	535	595
Общий вес с аккумулятором / с упаковкой, кг	-	40/48	42/50	38/46	45/49
Диам. поворота (ножки сдвинуты)	-	1280	1280	1070	1280
Скорость подъёма (без нагрузки), м/с			не более 0,25		
Скорость подъёма (полная нагрузка), м/с			не более 0,15		
Максимальная высота		1150	1200	1100	1100

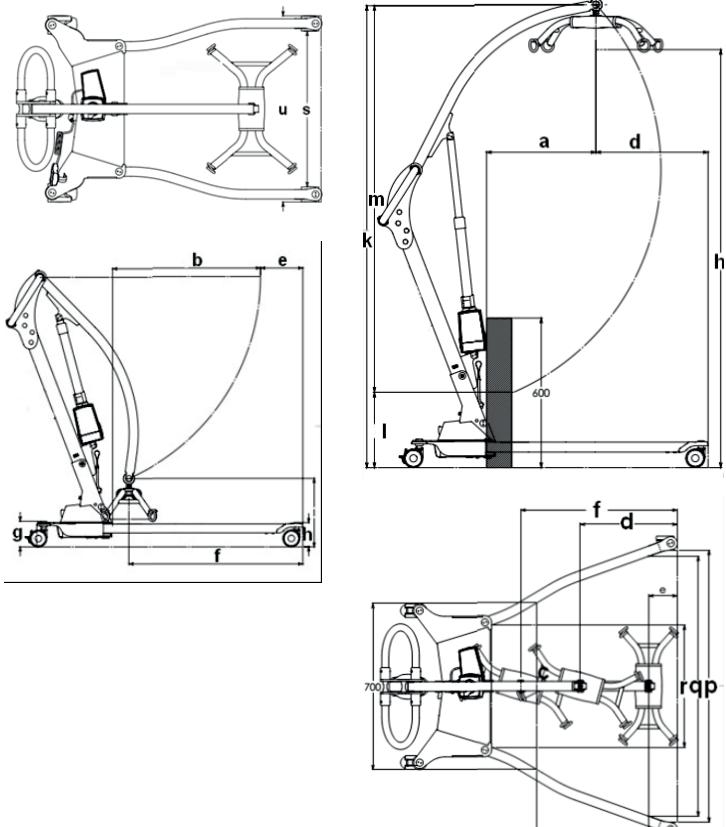

Классификация	Медицинские изделия, Класс I, тип B
Максимальная нагрузка	Для моделей: 401, 402, 403, 404/1 - 150 кг 401, 402, 403, 404/2 - 180 кг 401, 402, 403, 404/3 - 250 кг
Привод подъёмника	24В - 5А
Передние колёса (соответствует, EN 12531)	2 шт Ø76,2 мм
Задние колёса (соответствует, EN 12531)	2 шт Ø101,6 мм
Количество подъёмов со 100% заряженным аккумулятором	60
Условия использования	Только для использования внутри помещений
Класс защиты оболочки IP	IP20
Эксплуатационный коэффициент	2/10

Температура использования	+10°C / +40°C
Уровень звуковой мощности	не более 49 дБ
Остаточная деформация на подвесах после снятия нагрузки	не более 2 мм
Минимальное усилие необходимое для перемещения, Н, не более	- 5 Н при воздействии пальцем; - 10 Н при воздействии рукой; - 300 Н при воздействии ногой; - 1,9 Н·м при поворотных усилиях
Усилие вращения колёс, не более Н	85
Блокировка колёс	есть (задние колёса)

#### Технические характеристики аккумулятора:

Напряжение	24В
Ёмкость	3 А/час
Класс защиты оболочки IP	IPX4
Температурный диапазон использования	+10°C / +40°C
Условия использования	Только для использования в помещениях
Устройства безопасности	Аварийный спуск: Батарея низкого заряда; Аварийный СТОП; Защита от перепадов напряжения, короткого замыкания

#### Технические характеристики зарядного устройства:

Поставляемое зарядное устройство может работать с любыми показателями сети переменного тока: напряжение от 100 В до 240 В, частота от 50 Гц до 60 Гц. Единственным необходимым адаптером является сетевой шнур питания переменного тока.

Входное напряжение AC	100-240 В AC (перем. тока)
Входная частота переменного тока	50-60 Гц
Выходное напряжение и частота постоянного тока	Нет данных, в зависимости от цикла зарядки (1)
Максимальный выходной ток	0,9 А
Температурный диапазон использования	-10°C / +40°C
Условия использования	Только для использования в помещениях
Устройства безопасности	Индикатор рабочего напряжения; Модуляций тока зарядки в зависимости от состояния заряда аккумулятора; Автоматическаястановка зарядки в подаче визуального сигнала в случае перегрева аккумулятора во время зарядки

#### Размеры подвесов

Подвес-гамак вариант исполнения 1		M	L	XL
		40-90 кг	70-12 кг	100-120 кг
A		780 мм	840 мм	910 мм
B		400 мм	450 мм	510 мм
C		450 мм	500 мм	560 мм
D		300 мм	360 мм	440 мм
Подвес-гамак вариант исполнения 2		M	L	XL
		40-90 кг	70-12 кг	100-120 кг
A		780 мм	840 мм	910 мм
B		400 мм	450 мм	510 мм
C		450 мм	500 мм	560 мм
D		300 мм	360 мм	440 мм
E		390 мм	410 мм	420 мм
Подвес-гамак вариант исполнения 3		M	L	XL
		40-90 кг	70-12 кг	100-120 кг
A		780 мм	840 мм	910 мм
B		400 мм	450 мм	510 мм
C		450 мм	500 мм	560 мм
D		300 мм	360 мм	440 мм
Подвес-гамак вариант исполнения 3		M	L	XL
		40-90 кг	70-12 кг	100-120 кг
A		780 мм	840 мм	910 мм
B		400 мм	450 мм	510 мм
C		450 мм	500 мм	560 мм
D		300 мм	360 мм	440 мм
E		390 мм	410 мм	420 мм

Конструкция подъёмников снабжена нескользящими ручками для перемещения пациента посредством второго лица.

#### 1.15 Описание материалов, содержащихся в ключевых функциональных элементах / блоках / частях медицинского изделия, в том числе, материалов, контактирующих с человеческим организмом

При изготовлении подъёмников должны использоваться материалы и комплектующие, предназначенные для ее изготовления, безопасность которых подтверждена в установленном порядке сертификатом соответствия, декларацией о соответствии или протоколом испытаний.

## 2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Освободите подъёмник от упаковки.

2. Проверьте его на предмет возможных повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.

3. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.


4. Заблокируйте колеса для безопасности и удобства сборки.

Поднимите колонны вверх, установите плечевые винты и шайбы в порядке, показанном на рисунке, и затяните их своими собственными ключами, чтобы проверить, прочны ли они.


**Внимание! Не стойте под колонной при установке, чтобы избежать случайного падения колонны и вызвать ушибы!**




Совместите стрелу с монтажным отверстием колонны, вверните винт и шайбу, установите мачту и колонну на место и, наконец, установите электропривод, зафиксируйте все гайки и проверьте, устойчива ли конструкция.



Выньте аккумулятор и поместите монтажные отверстия на задней панели электрической коробки (электропривода) в крепёжные винты на колонне. Нажмите ручку в заблокированное состояние, как показано на рисунке, а затем установите корпус батарейного отсека обратно в электрический блок управления

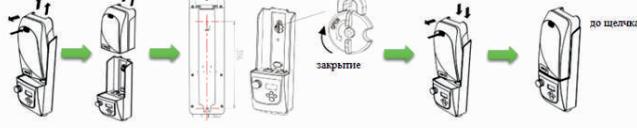

Вставьте крючок в боковое отверстие блока управления, чтобы облегчить хранение шнура.

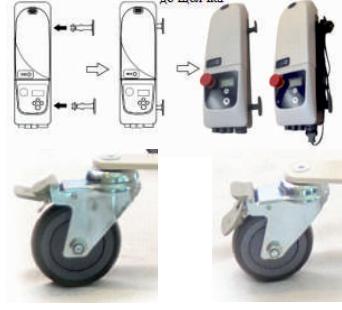

Заднее колесо подъёмника может быть заблокировано для предотвращения вращения и бокового перемещения. Нога используется для управления открытием и закрытием тормоза заднего колеса.

**Внимание! Блокировка колеса во время движения подъёмника увеличит риск падения вниз с подъёмника**

Во время использования всегда держите блок управления перпендикулярно центру тяжести пациента

#### Зарядка

Когда батарея разряжена, электрический блок управления издаст 4 последовательных звуковых сигнала и загорится красный светодиод, подсказывающий, что его необходимо немедленно зарядить. Если батарея не заряжена, подъёмники не будут работать.

**Внимание! При зарядке, пожалуйста, выключите кнопку аварийной остановки и перезарядите аккумулятор.**

**Внимание! Когда подъёмник не используется в течение длительного времени, его необходимо заряжать, чтобы поддерживать работоспособность аккумулятора.**

**Внимание! Не заряжайте аккумулятор во влажной среде.**

Для зарядки вставьте сетевой шнур в розетку. В зависимости от остаточного уровня зарядки батареи, процесс зарядки может занять до 10 часов. После зарядки отключите вилку из розетки и накрутите шнур на крючок блока управления.



Функция экстренный СТОП

Функция используется в экстренной ситуации и при неправильном функционировании подъёмника.

При нажатии кнопки аварийного отключения (экстренный СТОП), кнопка фиксируется. Система привода блокируется и не реагирует.

При повторе кнопки аварийного отключения по часовой стрелке, она со щелчком освобождается. Теперь привод может работать.

#### Регулировка опоры подъёмника

Регулирование ширины передних колёсных опор позволяет разводить их для увеличения площади опоры либо сдвигать их для перемещения поузким пространствам, например, для того, чтобы транспортировать пациента в ванную комнату.

**Внимание! Обязательно снимайте колеса с тормозов при регулировке ширины основания подъёмника!**

На крюки подъёмного устройства подъёмника крепятся подвесы-гамаки для перемещения пациента



**ВАЖНО! Для обеспечения равномерной нагрузки обязательно используйте все 4 крюка подъёмного устройства!**

#### Подвесы-гамаки

Различные варианты подвесов предлагаются как дополнительная опция и подбираются, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей пациента.

Рекомендуется использовать только оригинальные подвесы, соответствующие стандартам прочности, удобства и безопасности.

## 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 3.1. Текущий ремонт

Неправильности и их устранение

Неправильности отображаются на пульте управления с загоранием светодиодного индикатора. Пульты управления имеют три состояния светодиодного индикатора аккумулятора: зелёный, красный и красный мигающий. Красный светодиод означает, что батарея нужно зарядить.

Светодиод аккумулятора	Светодиод техобслуживания
● Ровный зелёный = осталось заряда на выполнение более 10 циклов	● Ровный оранжевый: неисправность. Воспользуйтесь программным инструментом техобслуживания или свяжитесь с нами для выполнения техобслуживания.
● Ровный красный = осталось менее 10 циклов для полной разрядки аккумулятора	● Мигающий оранжевый: периодический осмотр должен быть выполнен в ближайшие 2 месяца
● Мигающий красный: предупреждение о проблеме с аккумулятором (остался один цикл до полной разрядки аккумулятора)	● Мигающий красный: периодический осмотр не был выполнен вовремя

Примечание о светодиодном индикаторе техобслуживания:  
Этот индикатор используется для указания на возможную неисправность и на состояние периодических осмотров. Таким образом, он может указывать на несколько последовательных состояний.

Например, в случае неисправности и при превышении срока периодического осмотра, светодиодные индикаторы высвечиваются попеременно мигающий КРАСНЫЙ и ровный ОРАНЖЕВЫЙ.

Контролировать светодиодный индикатор техобслуживания легко:

- случай, человеческий фактор или выполнение техобслуживания, или чистки не подходящими для этого изделиями.

- Невыполнение регулярного и ежегодного техобслуживания

Контролировать светодиодный индикатор техобслуживания легко:

- Постоянный ровный свет = неисправность.

- Постоянно горящий свет = неисправность подъёмника = необходима замена главного предохранителя.

- Мигающий свет = управляемый индикатором замками.

- При несоблюдении эксплуатационного коэффициента подъёмника (2/10), может привести к тому, что на пульте управления появится ложное сообщение «аккумулятор разряжен».

В этом случае необходимо сделать следующее:

- Вывнуть аккумулятор из отсека

- Подождать 10 секунд

Это действие заставляет электронику выполнить перезагрузку ибросить предупреждение о «ложной» тревоге.

В случае обнаружения неисправностей следует обратиться в авторизованный сервисный центр производителя или уполномоченному представителю:

JIANGSU INTCO MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

адрес: #77 Yanlungshan Rd, Dagang Zhenjiang, Jiangsu Province, 212132, P.R.China

Юридический адрес: 107564, город Москва, Мясниковская 1-я улица, дом 18, квартира 13

Емкость аккумулятора и его техническое обслуживание:

Если не использовать подъёмник в течение долгого времени, необходимо следующее, чтобы сохранить аккумулятор в хорошем состоянии:

- Полностью зарядить аккумулятор (время полной зарядки ~ 5 ч).

- Нажать кнопку аварийной остановки

- Хранить заряженный аккумулятор в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте.

- Периодически (каждые три месяца) проверять состояние заряда аккумулятора: аккумуляторы имеют тенденцию к разрядке, даже если они не подключены.

Соблюдение этих мер предосторожности поможет продлить жизнь аккумулятора и пользоваться оборудованием в наиболее оптимальных условиях.

Если не следовать указаниям выше, то гарантия на аккумулятор аннулируется, так как он может прийти в негодность вследствие недостаточного техобслуживания.

### 3.2 Чистка и дезинфекция

Общие требования:

- всегда соблюдайте общие требования гигиени и пользуйтесь защитными средствами (перчатки, очки, спецодежда и маски, если необходимо);

- дезинфицируйте руки, даже после того, как снимете защитные перчатки;

- соблюдайте сроки годности используемых изделий;

- соблюдайте правила работы с радиоактивными материалами;

- никогда не смешивайте различные очистки средства и дезинфектанты;

- в случае контакта веществ с глазами, промойте водой, обратитесь к врачу, если боль не проходит;

= никогда не выполняйте чистку или дезинфекцию, если устройство подключено к сети: отключите устройство от сети/источника переменного тока.

**Рекомендованные процедуры по очистке и дезинфекции:**

- Устройство следует чистить специальными очистителями/или дезинфицировать по меньшей мере один раз в месяц.

Подготовка оборудования к дезинфекции: Цель: облегчить очистку, снизить уровень заражённости, обеспечить защиту медперсонала и окружающую среду.

Очистка: удаление загрязнений.

Дезинфекция: уничтожение или дезактивация микрорганизмов.

Сушка: удаление излишнего влаги с оборудования.

Хранение: содержание в чистоте уже дезинфицированных устройств.

При очистке и дезинфекции изделий следует избегать использования следующих веществ:

- уксусная кислота в концентрации > 10%;

- органические растворители типа галогенированных/ароматизированных углеводородов или ацетона;

- изделия с содержанием pH > 8 и < 5;

- изделия, содержащие коррозионные вещества или щёлочки.

3.4 Защита окружающей среды, в том числе требования безопасного уничтожения и утилизации.

Подъёмники должны быть нетоксичными и соответствовать требованиям ISO 10993-1.

При производстве, хранении, транспортировке и эксплуатации (потреблении) подъёмников не выделяют в окружающую среду токсических веществ и не оказывают (при непосредственном контакте) вредного влияния на организм человека. Работа с подъёмниками требует особых мер предосторожности, описанных выше. Критерий опасности медицинских отходов - класс Б. Кровь не содержит радиоактивных металлов.

Утилизация подъёмников должна быть проведена в соответствии с «Утилизацией электрического и электронного оборудования».

В целях сохранения окружающей среды утилизация электронного оборудования может быть реализована надлежащим образом.

### 3.5 Требования к транспортированию и хранению

Хранение: хранение в чистом месте, свободном от воздействия температуры, влажности, вентиляции, солнечных лучей, пыли и влаги, содержащем соль и т.д.

Избегайте мест, где хранятся химические препараты или образовывается газ.

Берегите от попадания влаги.

Условия хранения:

- температура: +10 ° ... +40 ° C

- относительная влажность: 40 ... 70 %

- атмосферное давление: 86 ... 106 kPa

Транспортировка подъёмников и принадлежностей допускается всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температурном режиме:

- температура: -30 ° ... +50 ° C

- относительная влажность: ≤ 85 %

- атмосферное давление: 86 ... 106 kPa

Логистика: маркировка изделия должна быть сделана в соответствии с «Утилизацией электрического и электронного оборудования».

Подъёмники для пациентов и все их составные части имеют срок гарантии два года, за исключением аккумуляторов (нет гарантии).

- Все виды вмешательства в работу оборудования, отличные от описанных в Руководстве, полностью аннулируют гарантию.

- Все виды ненормального или несоответствующего использованию приведут к полной отмене гарантии.

- Любые изменения устройства приведут к аннулированию гарантии.

- Использование неподходящих запасных частей, обработка, настройка и ремонт, выполненные не квалифицированным персоналом или не авторизованным дистрибутором, приведут к аннулированию гарантии.

- Ненормальные условия для использования оборудования, халатность, несчастный случай, человеческий фактор или выполнение техобслуживания, или чистки не подходящими для этого изделиями.

- Невыполнение регулярного и ежегодного техобслуживания

## 4. МАРКИРОВКА

### 4.1 Описание маркировки МИ

Маркировка должна быть выполнена типографским или печатным способом на бумажном ярлыке, и нанесена на поверхности, не видимых при эксплуатации, с указанием:

1. Товарный знак предприятия-изготовителя;

2. Наименование или обозначение типа (вида, модели) подъёмника;

3. Номер подъёмника по системе нумерации предприятия-изготовителя, при необходимости (серийный номер);

4. Дата изготовления подъёмника;

5. Символы по электробезопасности;

6. Название изделия и местное тече-изделие (арттик-если есть);

7. Несоответствие указаниям или рекомендациям, содержащимся в Руководстве по эксплуатации;

8. Использование неподходящих запасных частей;

9. Обработка, настройка и ремонт, выполненные не квалифицированным персоналом или не авторизованным дистрибутором;

10. Ненормальные условия для использования оборудования, халатность, несчастный случай, человеческий фактор или выполнение техобслуживания, или чистки не подходящими для этого изделиями;

11. Невыполнение регулярного и ежегодного техобслуживания

Примечание - Допускается наносить на маркировку манипуляционные знаки, поясняющие способ транспортировки, погрузки-разгрузки и хранения продукции.

4.2 Описание символов, нанесенных на маркировку МИ

Соответствует директиве ЕС

Евразийское соответствие

Прочтите руководство для дальнейших указаний

Для использования внутри помещений

### 3.3 Процесс упаковки изделия

Упаковка обеспечивает защиту подъёмников и принадлежностей от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения. Упаковывается в картонную коробку.

**5. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СУЩЕСТВЕННЫМ ПРИНЦИПАМ****5.1 Международные стандарты**

EN ISO 60601-1 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик

EN ISO 60601-1-2 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания.

EN ISO 13485:2016 Система Управления Качеством

EN ISO 14971:2012 Применение менеджмента риска на медицинские изделия

EN ISO 15223-1:2012 Изделия медицинские. Символы применяемые при маркировании

DIN EN ISO 10535-2007 Подъемники для инвалидов. Требования и методы испытаний

ISO 10993-1:2018 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

**5.2 Национальные стандарты**

DIN EN ISO 10535-2007 Подъемники для инвалидов. Требования и методы испытаний

5.3. Перечень сертификатов, деклараций соответствия национальными международным Стандартам

· ISO13485

· CE Declaration

**6. ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СОСТАВЕ ИЗДЕЛИЯ НЕТ.****ПОДЪЁМНИКИ НЕ СТЕРИЛЬНЫ.****7. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РФ**

(наименование, адрес, телефон, почта)

Общество с ограниченной ответственностью "АОРТИС"

107497, г. Москва, ш. Щелковское, д. 79, к. 1, кв. 444

**8. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18399 от 29 сентября 2022 года.